



**SZPITAL PUCKI sp. z o.o.**  
**84-100 Puck, ul. 1 Maja 13 A**  
**SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU**  
tel. +48 58 380-02-91  
fax +48 58 333-40-91  
e-mail: sekretariat@szpitalpucki.pl

Puck, dn. 26.08.2020 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych oraz gotowych materiałów z włókniny, znak ZP/05/2020**

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany jej treści.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	<b>Część 6, poz. 20</b> Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania fartuchów, gdzie mankiety, obszycie wokół szyi, rzepy są przyszyte do materiału bazowego, pozostałe elementy są zgrzane ultradźwiękami. Fartuchy w rozmiarach: M/L, XL. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów gdzie mankiety, obszycie wokół szyi, rzepy są przyszyte do materiału bazowego, pozostałe elementy są zgrzane ultradźwiękami. Fartuchy w rozmiarach: M/L, XL, z zachowaniem pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.
2.	<b>Część 6, poz. 21</b> Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> . w obszarze krytycznym tkanina wzmacniająca o gramaturze min. 28 g/m <sup>2</sup> ). Rozmiar fartucha oznaczony literowo M/L i XL. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania fartuchów: Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Mankiety, obszycie wokół szyi, rzepy są przyszyte do materiału bazowego, pozostałe	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


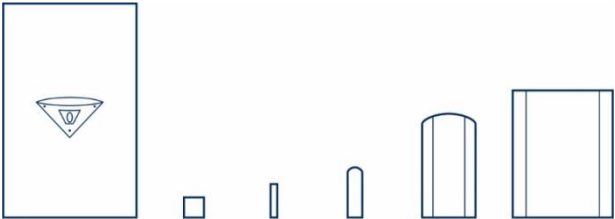
	<p>elementy są zgrzane ultradźwiękami. Wzmocnienia są przyklejone klejem do materiału bazowego.</p> <p>Wymiary wzmocnienia z przodu fartucha: M-L : 40x60 cm, XL: 40x 70 cm. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho powierzchnia krytyczna przód/ rękaw: 109N/ 70N, powierzchnia mniej krytyczna przód/ rękaw: 80N/ 42N. Wytrzymałość na rozciąganie na mokro powierzchnia krytyczna przód/ rękaw: 112N/ 67N, powierzchnia mniej krytyczna przód/ rękaw: 84N/ 41N. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795.</p>	
3.	<p><b>Część 6, poz. 22</b></p> <p>Prosimy o dopuszczenie serwety na stolik Mayo składanej w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację oraz taśmy pakowanej osobno , pozostałe parametry zgodne z SIWZ</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety na stolik Mayo składanej w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację oraz taśmy pakowanej osobno, z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ</p>
4.	<p><b>Część 6, poz. 23</b></p> <p>Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu:</p> <p>1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm</p> <p>2 ręczniki 30 cm x 40 cm</p> <p>1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację</p> <p>1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm</p> <p>1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm</p> <p>1 serweta ginekologiczna 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm</p> <p>Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.</p>
5.	<p><b>Część 6, poz. 24</b></p> <p>Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu:</p> <p>1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm</p> <p>4 ręczniki 30 cm x 40 cm</p> <p>1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm</p> <p>1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny</p> <p>1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.</p>

	<p>otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,.  Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm ) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.  Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ</p>	
6.	<p><b>Część 6, poz. 25</b>  Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu:  1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm  2 ręczniki 30 cm x 40 cm  1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację  1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm  1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm  1 serweta samoprzylepna z wycięciem ""U"" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm  1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm  Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.</p>
7.	<p><b>Część 6, poz. 26</b>  Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu:  1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, Wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm  2 ręczniki do rąk z celulozy 30 cm x 40 cm  1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację  1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm  1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm z zakładkami pozwalającymi na odklejenie w rękawiczkach  1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm  1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytemi do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep  Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m<sup>2</sup>.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.</p>
8.	<p><b>Część 6, poz. 27</b></p>	<p>Zamawiający dopuszcza</p>

	<p>Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu:</p> <p>1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm</p> <p>2 ręczniki do rąk z celulozy 30 cm x 40 cm</p> <p>1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację</p> <p>1 osłona ortopedyczna ( elastyczna) na kończynę, krótka 24 cm x 80 cm</p> <p>1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm z zakładkami pozwalającymi na odklejenie w rękawiczkach</p> <p>1 samoprzylepna serweta do artroskopii stawu barkowego 225 cm x 380 cm z samouszczelniającym się otworem w kształcie gruszki 11,5 cm x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów posiadającą sztywnik z zaworem do podłączenia drenu z trzema uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep</p> <p>Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m<sup>2</sup>.</p>	zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.
9.	<p><b>Część 6, poz. 28- 31</b></p> <p>Prosimy o wyłączenie : Poz. 28 -31 z części 6 do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie ofert konkurencyjnych większej liczbie Oferentów.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10.	<p><b>zadanie 4 poz. 10</b></p> <p>Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 36g/m<sup>2</sup> celuloza + folia min. 15 mikronów, pozostałe parametry jak w SIWZ?</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11.	<p><b>zadanie 4 poz. 11</b></p> <p>Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 34g/m<sup>2</sup>, z perforacją 37,5cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
12.	<p><b>zadanie 5 poz. 12</b></p> <p>Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze granatowym?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszuli w kolorze granatowym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
13.	<p><b>zadanie 5 poz. 13</b></p> <p>Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?</p>	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
14.	<p><b>zadanie 5 poz. 14</b></p> <p>Czy Zamawiający dopuści maskę FFP2?</p>	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
15.	<p><b>Zadanie 6</b></p> <p>Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje w tym zadaniu?</p>	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16.	<p><b>Zadanie 6, pozycja 20, 21</b> Czy Zamawiający dopuści fartuchy z dołączonymi 2 ręcznikami?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów z dołączonymi 2 ręcznikami. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
17.	<p><b>Zadanie 6, pozycja 21</b> Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o wzmocnieniu kończącym się 25-32 cm nad dolną krawędzią fartucha (w zależności od rozmiaru)?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów chirurgicznych o wzmocnieniu kończącym się 25-32 cm nad dolną krawędzią fartucha (w zależności od rozmiaru). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
18.	<p><b>Zadanie 6, pozycja 21</b> Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o wytrzymałości na rozciąganie na sucho 90MD/46.5CD, na mokro 91.6MD/48.7CD (parametry w strefie krytycznej)?</p>	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
19.	<p><b>Zadanie 6, pozycja 23</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych, jałowy o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm</li> <li>• 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup></li> <li>• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm</li> <li>• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm</li> <li>• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm</li> <li>• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm</li> </ul> <p>Serweta do obłożenia pacjenta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów.</p>	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.

	<p>160/240x180cm 1szt./pc.</p> <p>75x90cm 1szt./pc.</p> <p>30x30cm 4szt./pcs</p> <p>10x50cm 1szt./pc.</p> <p>80x140cm 1szt./pc.</p> <p>150x190cm 1szt./pc.</p>	
20.	<p><b>Zadanie 6, pozycja 24</b></p> <p>Czy zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z serwetą główną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>?</p>	Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SWIZ.
21.	<p><b>Zadanie 6, pozycja 25</b></p> <p>Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żyłaków, jałowy, o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm</li> <li>• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm</li> <li>• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm</li> <li>• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm</li> <li>• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm</li> </ul> <p>200x260cm 1szt./pc.</p> <p>160x180cm 1szt./pc.</p> <p>30x30cm 4szt./pcs</p> <p>80x140cm 1szt./pc.</p> <p>150x190cm 1szt./pc.</p>	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.
22.	<p><b>Zadanie 6, pozycja 26</b></p> <p>Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii, jałowy o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów, samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym</li> <li>• 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm</li> <li>• 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30</li> </ul>	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.

	<p>cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm</li> <li>• 1 x serweta elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 30 cm x 60 cm</li> <li>• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm</li> <li>• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm</li> </ul>  <p>200x320cm 1szt./pc.</p> <p>30x30cm 2szt./pcs</p> <p>10x50cm 3szt./pcs</p> <p>14x250cm 1szt./pc.</p> <p>30x60cm 1szt./pc.</p> <p>80x140cm 1szt./pc.</p> <p>150x190cm 1szt./pc.</p>	
23.	<p><b>Zadanie 6, pozycja 27</b></p> <p>Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji barku, jałowy o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym</li> <li>• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm, celulozowe, o podwyższonej chłonności</li> <li>• 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm</li> <li>• 1 x elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 22 cm x 75 cm</li> <li>• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm</li> <li>• 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.</li> </ul>  <p>230x320cm 1szt./pc.</p> <p>30,5x34cm 4szt./pcs</p> <p>10x50cm 3szt./pcs</p> <p>22x75cm 1szt./pc.</p> <p>80x145cm 1szt./pc.</p> <p>150x190cm 2szt./pcs</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.</p>

24.	<b>Zadanie 6, pozycja 28, 29, 30, 31</b> Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?	Tak, Zamawiający dopuszcza próbki niesterylne.
25.	<b>Zadanie 6, pozycja 28</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do małych zabiegów chirurgicznych w opakowaniu typu folia-papier?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do małych zabiegów chirurgicznych w opakowaniu typu folia-papier. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
26.	<b>Zadanie 6, pozycja 28</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do małych zabiegów chirurgicznych z serwetą 50 x 75 cm z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm (w miejsce serwety w rozmiarze 0 x 60cm z centralnym otworem samoprzylepnym o rozm. 10cm)?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach opisanych w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
27.	<b>Zadanie 6, pozycja 28</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do małych zabiegów chirurgicznych z pęsetą chirurgiczną metalową 14,5 cm (zamiast 12 cm)?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do małych zabiegów chirurgicznych z pęsetą chirurgiczną metalową 14,5 cm (zamiast 12 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
28.	<b>Zadanie 6, pozycja 28</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do małych zabiegów chirurgicznych z nożyczkami metalowymi 11,5 cm (zamiast 11 cm)?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do małych zabiegów chirurgicznych z nożyczkami metalowymi 11,5 cm (zamiast 11 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
29.	<b>Zadanie 6, pozycja 28</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do małych zabiegów chirurgicznych z imadłem metalowym 15 cm (zamiast 13 cm)?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do małych zabiegów chirurgicznych z imadłem metalowym 15 cm (zamiast 13 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
30.	<b>Zadanie 6, pozycja 28</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do małych zabiegów chirurgicznych z wklejkami typu TAG z informacjami: REF/LOT/data ważności oraz kodem kreskowym?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do małych zabiegów chirurgicznych z wklejkami typu TAG z informacjami: REF/LOT/data ważności oraz kodem kreskowym. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
31.	<b>Zadanie 6, pozycja 29</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu jałowy z serwetą porodową 114 x 150 cm zintegrowana z torba do zbiórki płynów, gramatura 60g/m <sup>2</sup> , wzmocniona?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do porodu jałowy z serwetą porodową 114 x 150 cm zintegrowana z torba do zbiórki płynów, gramatura 60g/m <sup>2</sup> ,



		wzmocniona. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
32.	<b>Zadanie 6, pozycja 29</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu jałowy z podkładem chłonnym 90 x 60 cm, chłonność 1177ml?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
33.	<b>Zadanie 6, pozycja 29</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu jałowy z kleszczami metalowymi Pean prosty 18cm (zamiast 20 cm)?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do porodu jałowy z kleszczami metalowymi Pean prosty 18cm (zamiast 20 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
34.	<b>Zadanie 6, pozycja 29</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu jałowy z nożyczkami metalowymi do cięcia krocza 14,5 cm (zamiast 20 cm)?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
35.	<b>Zadanie 6, pozycja 30</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego w opakowaniu typu folia – papier?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego w opakowaniu typu folia – papier. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
36.	<b>Zadanie 6, pozycja 30</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego z serwetą podfoliowaną 50 x 70 cm (w miejsce serwety 45 x 75 cm)?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach opisanych w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
37.	<b>Zadanie 6, pozycja 30</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego z serwetą 50 x 75 cm z centralnym otworem 6 x 8 cm, z przylepcem (w miejsce serwety 45 x 75 cm z otworem 8 cm i przylepcem dookoła)?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach opisanych w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
38.	<b>Zadanie 6, pozycja 31</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego z serwetką podfoliowaną 50 x 70 cm (zamiast 45 x 75 cm)?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach opisanych w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
39.	<b>Zadanie 6, pozycja 31</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego z serwetką 50 x 75 cm z otworem przylepnym 6 x 8 cm (w miejsce serwety 50 x 60 cm z otworem 10 cm i przylepcem dookoła)?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach opisanych w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
40.	<b>Zadanie 6, pozycja 31</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego ze strzykawką 2 ml (zamiast 3 ml)?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
41.	<b>Część 2 poz. 3:</b> Czy Zamawiający oczekuje chusty trójkątnej bawełnianej w rozm. 134 cm x 95 cm x 95cm ?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Dopuszcza się zaoferowanie chusty o wymiarach podanych w

	Chusta o mniejszych rozmiarach uniemożliwia zastosowanie jej zgodnie z przeznaczeniem. Czy należy na potwierdzenie załączyć Kartę Danych Technicznych produktu?	pytaniu.
42.	<b>Część 2 poz. 4:</b> Czy Zamawiający dopuści tufery w rozm. 15x15 cm?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
43.	<b>Część 2 poz. 5:</b> Czy Zamawiający dopuści tufery kule w rozm. 20x 20 cm?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
44.	<b>Część 2 poz. 6</b> Czy Zamawiający dopuści tufery kule w rozm. 30x30 cm?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
45.	<b>Część 6 poz. 22, 26</b> Czy zamawiający oczekuje w zestawie taśmy medycznej z laminatu oraz z zakładką finger lift? Zakładka przy taśmie umożliwia zamocowanie jej w polu operacyjnym przez operatora w rękawiczkach. W zestawie gdzie taśma medyczna to zwykły przyklepic chirurgiczny nie jest możliwe jej przyklejenie w rękawiczkach.	Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza zaoferowanie w zestawie taśmy opisanej w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
46.	<b>Część 6</b> Czy zamawiający oczekuje, aby serwety główne w obłożeniu były bezpieczne pod względem cytotoxyczości a więc spełniały normę PN-EN 10993 w części 5 i 10, potwierdzone kdt dołączonej do oferty? Serwety spełniające tę normę są przebadane pod względem cytotoxyczości co znaczy że wykazują brak agresywnego działania na błony komórkowe ludzkiego organizmu.	Zamawiający oczekuje zaoferowania serwet głównych w obłożeniu zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
47.	Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?	Zgodnie z § 13 ust. 7 wzoru umowy „Przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”
48.	Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?	Zmiany umowy w tym zakresie opisane zostały w § 8 ust. 2 pkt 3 i 4 wzoru umowy.
49.	Czy Zmawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od kar umownych określonych w §7 ust. 1 pkt a)?	Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
50.	W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie	Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. Zasady postępowania związane z

	<p>ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w §7 wzoru umowy proponowanego zapisu:</p> <p><i>„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.</i></p>	<p>występowaniem COVID-19 opisane zostały w par. 9 wzoru umowy.</p> <p>Sposób postępowania stron dotyczący naliczania kar umownych wynika wprost z artykułu wymienionego w pytaniu oraz art. 15r<sup>1</sup> ustawy wymienionej w pytaniu.</p>
--	--	--

Z poważaniem